

EQUIPO:	BÁSCULA	MARCA:	CHARDER
---------	---------	--------	---------

DESCRIPCIÓN: Equipo utilizado para determinar el peso corporales de pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: I (RIESGO BAJO)



### GUÍA DE MANEJO

1	Asegúrese de que la báscula este en una superficie lisa y uniforme.
2	Pida al paciente que se quite los zapatos y cualquier objeto pesado que pueda afectar el resultado.
3	Pida al paciente que se pare en el centro de la báscula en posición vertical, sin apoyarse en ninguna superficie o persona.
4	Espere a que la báscula muestre el peso estable antes de registrar el resultado.
5	Es importante realizar al menos 3 mediciones para asegurarse del resultado.

### RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.
5	Utilizar la bascula sobre una superficie plana, no aplique una carga de choque a la bascula. No desmonte el equipo para realizar la limpieza ni mantenimiento.

### LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).


Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie su pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	BÁSCULA	MARCA:	GMD
---------	---------	--------	-----

DESCRIPCIÓN: Equipo utilizado para determinar el peso corporales de pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I (RIESGO BAJO)
--------------------------	-----------------

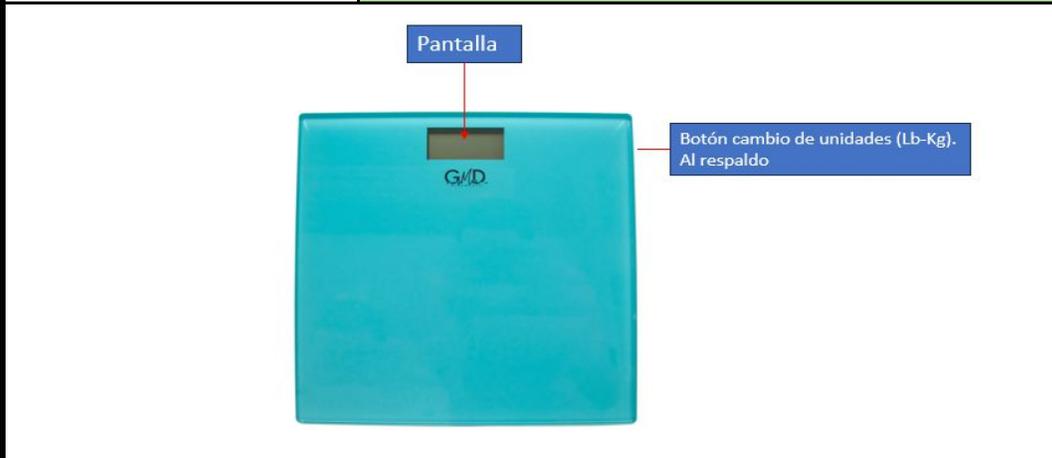

**GUÍA DE MANEJO**

1	Asegúrese de que la báscula este en una superficie lisa y uniforme.
2	Pida al paciente que se quite los zapatos y cualquier objeto pesado que pueda afectar el resultado.
3	Pida al paciente que se pare en el centro de la báscula en posición vertical, sin apoyarse en ninguna superficie o persona.
4	Espere a que la báscula muestre el peso estable antes de registrar el resultado.
5	Es importante realizar al menos 3 mediciones para asegurarse del resultado.

**RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS**

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.
5	Utilizar la bascula sobre una superficie plana, no aplique una carga de choque a la bascula. No desmonte el equipo para realizar la limpieza ni mantenimiento.

**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).


Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie su pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	BÁSCULA	MARCA:	ONE LIFE
---------	---------	--------	----------

DESCRIPCIÓN: Equipo utilizado para determinar el peso corporales de pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I (RIESGO BAJO)
--------------------------	-----------------

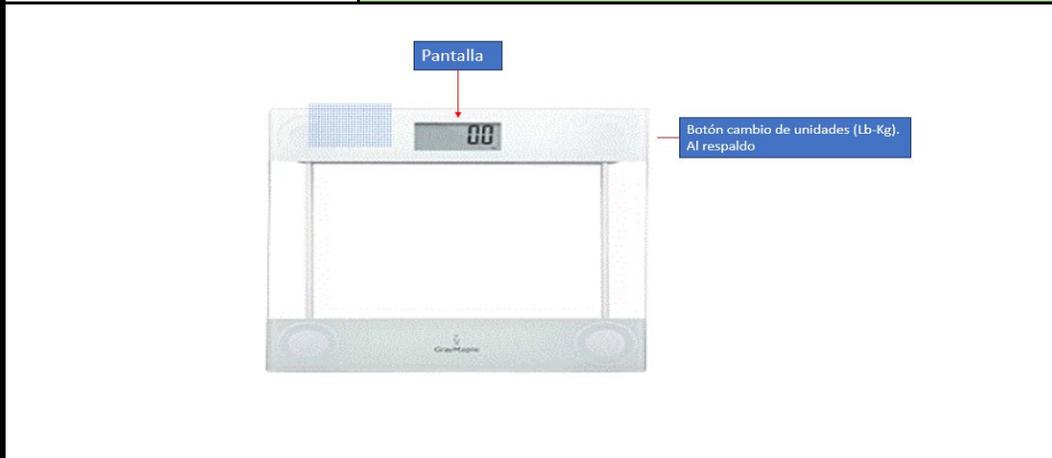

**GUÍA DE MANEJO**

1	Asegúrese de que la báscula este en una superficie lisa y uniforme.
2	Pida al paciente que se quite los zapatos y cualquier objeto pesado que pueda afectar el resultado.
3	Pida al paciente que se pare en el centro de la báscula en posición vertical, sin apoyarse en ninguna superficie o persona.
4	Espere a que la báscula muestre el peso estable antes de registrar el resultado.
5	Es importante realizar al menos 3 mediciones para asegurarse del resultado.

**RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS**

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.
5	Utilizar la bascula sobre una superficie plana, no aplique una carga de choque a la bascula. No desmonte el equipo para realizar la limpieza ni mantenimiento.

**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).


Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie su pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	BÁSCULA	MARCA:	STUDIO 24
---------	---------	--------	-----------

DESCRIPCIÓN: Equipo utilizado para determinar el peso corporales de pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I (RIESGO BAJO)
--------------------------	-----------------

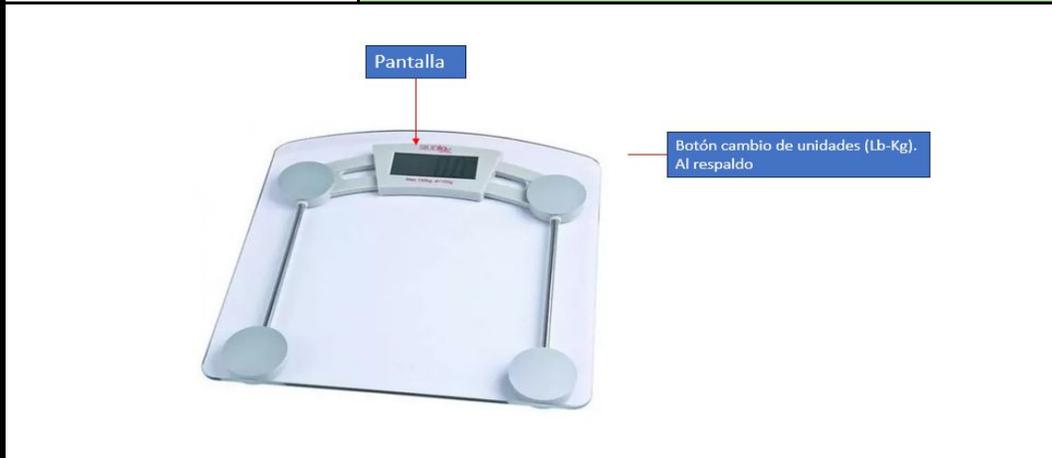

**GUÍA DE MANEJO**

1	Asegúrese de que la báscula este en una superficie lisa y uniforme.
2	Pida al paciente que se quite los zapatos y cualquier objeto pesado que pueda afectar el resultado.
3	Pida al paciente que se pare en el centro de la báscula en posición vertical, sin apoyarse en ninguna superficie o persona.
4	Espere a que la báscula muestre el peso estable antes de registrar el resultado.
5	Es importante realizar al menos 3 mediciones para asegurarse del resultado.

**RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS**

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.
5	Utilizar la bascula sobre una superficie plana, no aplique una carga de choque a la bascula. No desmonte el equipo para realizar la limpieza ni mantenimiento.

**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie su pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.